


iDAScore™

Felhasználói kézikönyv

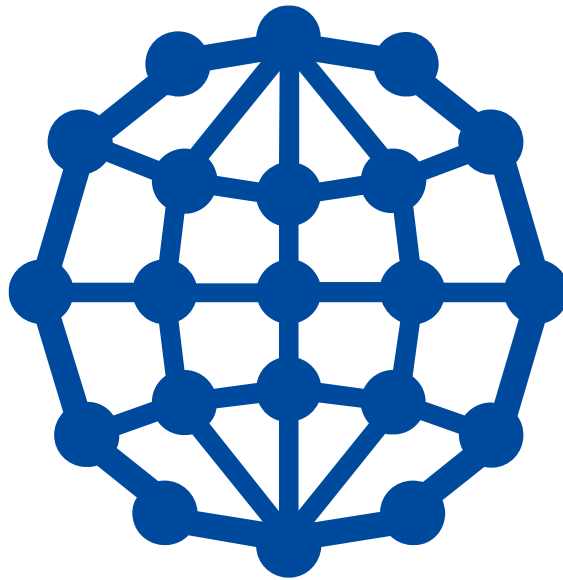

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	3
1.1	Az útmutatóban használt egyezményes jelzések	3
1.2	Fontos korlátozások és figyelmeztetések	3
1.3	Általános kiberbiztonsági ajánlások.....	4
1.4	Az iDAScore célja	4
1.5	Rendeltetésszerű használat.....	5
1.6	Használati utasítás.....	5
1.7	Célfelhasználók.....	5
1.8	Klinikai előny	5
1.9	Javasolt áthidaló megoldások	5
1.10	Az iDAScore használatával kapcsolatos követelmények.....	6
2	Vitrolife Technology Hub.....	6
3	iDAScore – alaplőködés	8
4	Az embriókhoz rendelt pontszámok	10
5	Embriók kiválasztása	11
5.1	Képek, time-lapse videók és annotációk	11
6	Véglegesítés és jelentéskészítés	14
7	Szimbólumok és címkék.....	17
8	Hulladékkezelés	18
9	Elérhetőségek	18

A CohortView, CulturePro, az EmbryoScope, az EmbryoSlide, az EmbryoViewer, a Guided Annotation, az iDAScore és a KIDScore a Vitrolife csoporthoz tartozó védjegyek vagy bejegyzett védjegyek.

©2021 Vitrolife A/S. Minden jog fenntartva.

1 Bevezetés

A felhasználói kézikönyvben útmutatást talál az iDAScore használatával kapcsolatban, amely automatikusan azonosítja az implantációra legnagyobb eséllyel rendelkező embriókat.

A felhasználói kézikönyvben az „EmbryoScope” készülékre vonatkozó összes hivatkozás az EmbryoScope+, az EmbryoScope Flex és az EmbryoScope 8 time-lapse inkubátorokra egyaránt érvényes. Az „EmbryoSlide”-ra utaló összes hivatkozás kiterjed az EmbryoSlide+, az EmbryoSlide+ ic8 és az EmbryoSlide Flex tenyésztőedényekre is.

A felhasználói kézikönyv összes képernyőfelvétele a szoftver angol verzióját mutatja. A vonatkozó fordítások kísérő szövegben szerepelnek.

1.1 Az útmutatóban használt egyezményes jelzések

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK: Funkciók vagy műveletek, amelyek csak bizonyos személyek által vagy célokra használhatók; illetve olyan szabályozási korlátozások, amelyeket KÖTELEZŐ betartani az iDAScore használata során.

FIGYELMEZTETÉSEK: Olyan állapotokra vagy műveletekre hívják fel a figyelmet, amelyek – az utasítások figyelmen kívül hagyása esetén – potenciálisan hibás adatokat vagy helyreállíthatatlan adatvesztést okozhatnak.

ÓVINTÉZKEDÉSEK: Fontos információk szükségesek az iDAScore használata előtt vagy közben.

MEGJEGYZÉSEK: Magyarázatok vagy kiegészítő információk, amelyek a jobb megértést szolgálják.

1.2 Fontos korlátozások és figyelmeztetések

Az iDAScore minden felhasználójának hozzá kell járulnia, hogy a jelen felhasználói kézikönyvet elolvassa és megértse, a használatra vonatkozó korlátozásokat betartsa és az alábbi figyelmeztetéseket elolvassa.

A közvetlenül vagy közvetetten a készülék és a kapcsolódó hardver használatából eredő incidensek és/vagy betegsgek, kezelők vagy karbantartók sérülése esetén azonnal forduljon a Vitrolife-hoz, és jelentse az esetet. A készülékkel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a felhasználó lakóhelye szerinti illetékes hatóság felé.

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK

- iDAScore készülékhez kapcsolódó minden jog a Vitrolife A/S tulajdonát képezi. Ha az iDAScore-t telepíti és használja, akkor arra a végfelhasználói licencszerződés feltételei érvényesek.
- Az iDAScore modellt nem másolhatja le, módosíthatja, fejtheti vissza és nem konvertálhatja, illetve nem ruházhatja át, adhatja át, adhatja el, adhatja bérbe, és nem kölcsönözheti az iDAScore-t harmadik félnek.

FIGYELMEZTETÉS

- Az iDAScore minden embrióhoz egy pontszámot rendel. A legalacsonyabb pontszámú embriók rendelkeznek statisztikailag a legkisebb implantációs eséllyel, és a legmagasabb pontszámú embriók pedig a statisztikailag legjobb beültetési eséllyel. A döntést, hogy mely embriók kerüljenek beültetésre, lefagyasztásra vagy mellőzésre, valamennyi releváns embrió minőségének értékelését követően mindig a felhasználónak kell meghoznia.

ÓVINTÉZKEDÉS

- Az iDAScore modellek nem használhatók más célra, mint amit a Vitrolife A/S előírányoz és meghatároz, mivel az eltérő használat az embriológus hibás döntéséhez vezethet.

MEGJEGYZÉS

- A kézikönyvben szereplő valamennyi név és kezelési adat teljes mértékben fiktív.

1.3 Általános kiberbiztonsági ajánlások

Javasoljuk és elvárjuk, hogy a felhasználók a kiberbiztonsági kockázat csökkentése céljából megtegyék a következő intézkedéseket, és biztosítsák az eszköz tervezett felhasználói környezetben történő működését:

- Gondoskodjon arról, hogy a személyzet megfelelő képzésben részesüljön a kiberbiztonsági tudatosság terén
- Akadályozza meg illetéktelen felhasználók fizikai hozzáférését a berendezéshez
- Használjon erős jelszavakat (legalább nyolc karaktert, beleértve a kis- és nagybetűket, számokat és legalább egy speciális karaktert).

A felhasználóknak bármilyen indokolatlan késedelem nélkül értesíteniük kell a Vitrolife A/S-t, amikor tudomást szereznek egy kiberbiztonsági rést okozó incidensről vagy feltételezett biztonsági eseményről.

1.4 Az iDAScore célja

Az iDAScore automatikusan azonosítja azokat az embriókat, amelyeknek a legnagyobb esélyük van az implantációra. Kiegészíti a klinikai döntéshozatalt, és a végső értékelést és döntést egészségügyi szakembernek kell elvégeznie.

Az iDAScore egy pontszámot rendel az egyes embriókhoz egy mély gépi tanulási mesterséges neurális hálózaton alapuló algoritmus alapján, amely megjósolja az EmbryoScope time-lapse

rendszerben tenyésztett embriók életképességét. Az embriók pontozásához használt információkat az ES server küldi. Az ES server fogadja a képadatokat a csatlakoztatott EmbryoScope(ok)-ról és az annotálási adatokat az EmbryoViewer szoftvertől.

ÓVINTÉZKEDÉS

- Az iDAScore egy kiválasztott EmbryoSlide tenyésztőedényben minden embrióhoz hozzárendel egy pontszámot. A pontszám döntéstámogatásként szolgál, sohasem helyettesítheti az embriológus döntését.

Az iDAScore egy I. osztályú eszköz, amely megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendelet követelményeinek.

1.5 Rendeltetészerű használat

A készülék kiértékeli a korai embriófejlődést a megszerzett embrió time-lapse videók segítségével, hogy segítse a beültetendő embrió kiválasztását. A készülék pontszámot rendel minden embrióhoz, amely azonosítja a beültetésre legnagyobb esélyű embriókat. A készülék kiegészíti a klinikai döntéshozatalt. A végső értékelést és döntést az egészségügyi szakembernek kell elvégeznie.

1.6 Használati utasítás

Az iDAScore az IVF-páciensek embrióinak értékelésére szolgál. Az iDAScore-t EmbryoScope time-lapse rendszerrel együtt kell használni.

1.7 Célfelhasználók

Embriológusok illetve más laboratóriumi személyzet és klinikai személyzet az IVF klinikákon.

1.8 Klinikai előny

Orvostechnikai eszköz tartozékként az iDAScore közvetett klinikai előnyt biztosít a döntéshozatali folyamat jobbá tételében a rendszerhez csatlakoztatott inkubátor(ok)ban inkubált embriók hatékony kiértékelése és jobb kiválasztása révén.

1.9 Javasolt áthidaló megoldások

Jelenleg nincsenek ismert anomáliák és korlátozások az iDAScore-ban.

1.10 Az iDAScore használatával kapcsolatos követelmények

Az iDAScore használatához a következők szükségesek:


- Egy EmbryoScope
- EmbryoViewer szoftver
- ES server telepített érvényes licencfájllal.

Ezenkívül a time-lapse videó minősége is fontos. Gondoskodjon a következőkről:

- Az embrió megfelelő denudálása, (kumulusz sejtektől mentes)
- A teljes embrió látható a tenyésztőedény indításakor
- Az embrió a vájat közepén helyezkedik el és fókuszban van a tenyésztés teljes időszakában
- Nincs légbuborék a vájatban.

2 Vitrolife Technology Hub

A Vitrolife Technology Hub moduljának használatához kattintson kétszer a Vitrolife Technology Hub asztali parancsikonyjára, vagy indítsa el a programot a Windows Start menüjében. Itt látható a Vitrolife Technology Hub kezdőlapja a klinikán használt modulokkal.

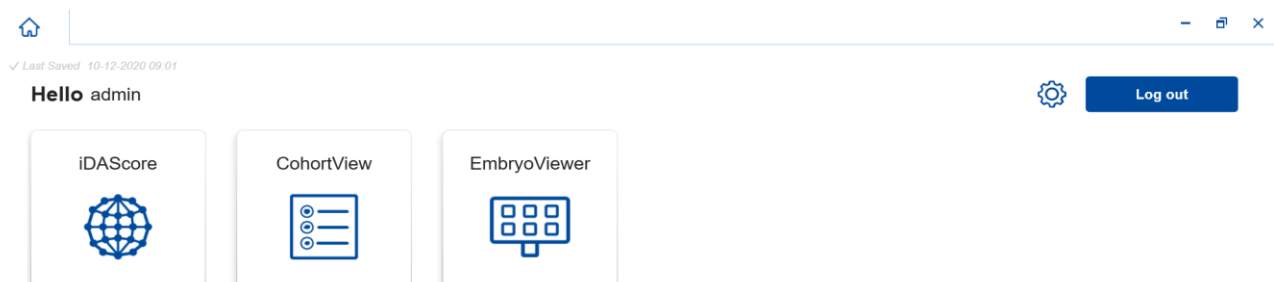

Modul megnyitásához kattintson az ikonra. Ha több modult nyit meg, minden modul új lapon nyílik meg. Bármelyik nyitott lapot bezárhatja a lapon található X gombra kattintva.

A **Log out** (Kijelentkezés) gomb melletti beállítások ikonnal a rendszer- és modulbeállításokhoz férhet hozzá.



✓ Last Saved 10-12-2020 09:05

< Dashboard

System Settings

Language

English (United Kingdom) ▼

Automatic Logout After Inactivity

10

Minutes



Platform Version

1.2.0

Module Settings

iDAScore ▼

CohortView ▼


A **System Settings** (Rendszerbeállítások) alatt választhat az elérhető kijelzőnyelvek közül a **Language** (Nyelv) legördülő listából; az **Automatic Logout After Inactivity** (Automatikus kijelentkeztetés inaktivitás után) részben beállíthatja az inaktivitási időszakot, amely után a felhasználót automatikusan kijelentkeztetik. A **Platform Version** (Platform verzió) alatt megtekintheti a platform aktuális verzióját.

A **Module Settings** (Modulbeállítások) alatt egy konkrét modul aktuális verziója és UDI (egyedi készülékazonosító) kódja látható. Az információ megnyitásához vagy bezárásához kattintson a modul neve melletti nyílra.

Kattintson a **Dashboard** (Vezérlőpult) linkre a modul áttekintésébe való visszatéréshez.

3 iDAScore – alapműködés

Az iDAScore első megnyitásakor a nyitóoldal nem tartalmaz információt.

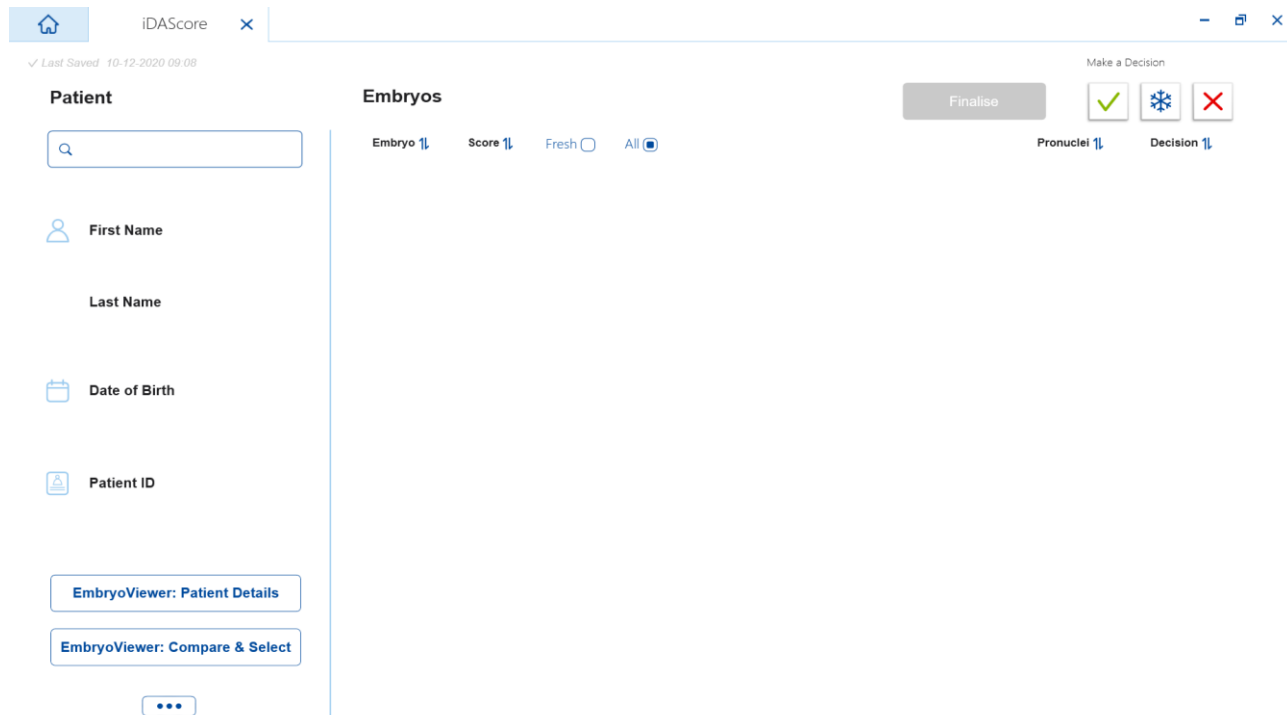

Adja meg a beteg nevét, a betegazonosítót vagy a kezelésazonosítót a képernyő bal oldalán található keresőmezőben egy adott beteg vagy kezelés kereséséhez.

A **First Name** (Utónév), a **Last Name** (Vezetéknév), a **Date of Birth** (Születési dátum) és a **Patient ID** (Betegazonosító) mezők automatikusan kitöltésre kerülnek a beteg adataival; a beteg embrióinak pontszámai a képernyő jobb oldalán lesznek kiszámítva és megjelenítve. Válassza a **Fresh** (Friss) lehetőséget csak a friss embriók, illetve az **All** (Összes) opciót a friss és a fagyasztott embriók pontszámának megtekintéséhez. A friss embriók olyan embriók, amelyeket az elmúlt 10 napon belül termékenyítettek meg.

The screenshot shows the iDAScore interface. On the left, the 'Patient' section displays details for 'Sophia Brown - 005':

- First Name:** Sophia
- Last Name:** Brown
- Date of Birth:** 01-02-1990
- Patient ID:** 005

Below the patient details are two buttons: 'EmbryoViewer: Patient Details' and 'EmbryoViewer: Compare & Select'. The main area shows a list of embryos with the following columns: Embryo, Score, Fresh/All status, Pronuclei, and Decision. The embryos are sorted by score in descending order.

Embryo	Score	Fresh	All	Pronuclei	Decision
AB-1	3.7	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-2	2.1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-3	2.0	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-4	-	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1 PN!	
AB-5	9.1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-6	4.5	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-7	7.2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-8	8.9	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-9	4.0	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
AB-10	1.9	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		

A számításokat az embrióazonosító, a pontszám vagy az előmagok száma alapján rendezheti. Ha döntést hozott az embriókról (lásd 5), a rendezés döntés szerint is lehetséges. Kattintson az adott irányra egyszer az adatok csökkenő sorrendbe rendezéséhez, illetve kétszer az adatok növekvő sorrendbe rendezéséhez. Alapértelmezés szerint a számítások embrióazonosító szerint, növekvő sorrendben jelennek meg. Ha megváltoztatja a rendezést, a nézet visszaáll az alapértelmezett rendezésre, amikor legközelebb megnyitja a beteg adatait.

Ha szeretné megtekinteni a részletes páciens- és kezelési adatokat, vagy pontozási modellt alkalmazni a páciens embrióira, a képernyő bal alsó oldalán lévő két gombbal közvetlenül a **Patient Details** (Páciens adatok) vagy a **Compare & Select** (Hasonlítsd össze és válaszd ki) oldalra kerül az EmbryoViewer szoftverben. További információért olvassa el az EmbryoViewer felhasználói kézikönyvének ezen oldalait.

[EmbryoViewer: Patient Details](#)

[EmbryoViewer: Compare & Select](#)

Kattintson a képernyő bal alsó sarkában található három ponttal ellátott gombra, hogy közvetlenül a Vitrolife Technology Hub másik moduljába lépjen. Válasszon egy lehetőséget a megjelenő listából a gombra kattintva.



4 Az embriókhoz rendelt pontszámok

Minden embrió 1 és 9,9 közötti számértéket kap, és a pontsáv sötétszürkén jelenik meg, amíg az embrióról nem születik döntés (lásd 5). Ha nem lehet pontszámot kiszámítani, a pontsáv világosszürke színű. Helyezze a kurzort a gondolatjel fölé a **Score** (Pontszám) oszlopban a részletek megtekintéséhez.



ÓVINTÉZKEDÉS

- A tenyésztőedényt legkésőbb 24 órával a megtermékenyítés után be kell helyezni az inkubátorba, hogy ki lehessen számítani a pontszámot.
- Nincs információ, ha az embriótenyésztés 112 óránál rövidebb ideig zajlik.

A legmagasabb pontszámmal rendelkező embriók rendelkeznek a statisztikailag legjobb beültetési eséllyel. A végső döntést arról, hogy melyik embrió kerüljön beültetésre, fagyasztásra vagy mellőzésre, mindig az embriológusnak kell meghoznia az egyes embriók gondos mérlegelését követően. A pontszámok támogathatják a döntést, de soha nem szolgálhatnak annak helyettesítőjeként.

Ha egy embriónak nincs két előmagja (PN), akkor nem jelenik meg pontszám az embriónál, és a PN érték a **Pronuclei** (Előmag) alatt figyelmeztető jelzéssel (!) jelenik meg. A PN értéket szükség esetén manuálisan módosíthatja (lásd 5.1).



Ha nem áll rendelkezésre PN becslés, és a PN értéke nincs annotálva, vagy **NA**-ként van annotálva, egy pontszám jelenik meg az embriónál, és egy figyelmeztető jelzés látható a **Pronuclei** (Előmag) alatt. Helyezze a kurzort a figyelmeztető jelzések fölé a részletek megtekintéséhez.



5 Embriók kiválasztása

Amikor láthatók a paciens embrió-pontszámai, a döntés gombokkal a **Make a Decision** (Döntéshozatal) alatt jelezheti, mely embrió(k) kerüljenek beültetésre (zöld ikon), lefagyasztásra (kék ikon) vagy mellőzésre (piros ikon). A zöld ikonos döntés gomb segítségével friss és fagyasztott embriók is kiválaszthatók a beültetésre. Ezen gombok egyikére kattintva a megfelelő ikon követi a kurzort, majd egy jelölőnégyzet látható a **Decision** (Döntés) részben minden embrió esetében. Kattintson az összes embrió jelölőnégyzetére, amelyekre alkalmazni szeretné a döntést. Kattintson ismét ugyanazon döntés gombra a kurzor normál használatához való visszatéréséhez, vagy kattintson a többi döntés gomb egyikére, ha egy vagy több embrióra más döntést kíván alkalmazni.

Ha vissza szeretné vonni a döntést, kattintson a megfelelő döntés gombra, majd az érintett embrió jelölőnégyzetére. Ez törli a jelölőnégyzet jelölését.

Amikor egy döntést alkalmaz egy embrióra, az embrió pontsávja ennek megfelelően színt vált. A friss beültetésre kiválasztott embriók esetében a pontsáv zöldre változik. A fagyasztásra kiválasztott embrióknál kék színű, a beültetésre kiválasztott fagyasztott embrióknál pedig lila színű lesz. A mellőzésre kijelölt embrióknál az egész sor halvány.

The screenshot shows the 'Embryos' section of the iDAScore interface. At the top right, there is a 'Make a Decision' section with a 'Finalise' button and three decision icons: a green checkmark, a blue snowflake, and a red 'X'. Below this, there are filters for 'Embryo', 'Score', 'Fresh', and 'All'. The main table lists four embryos: AB-5 (Score 9.1, green bar), AB-7 (Score 7.2, blue bar), AB-8 (Score 8.9, purple bar), and AB-9 (Score 4.0, grey bar). Each row has an eye icon, a decision icon, and a right arrow. The decision icons are: green checkmark for AB-5, blue snowflake for AB-7, purple snowflake for AB-8, and red 'X' for AB-9.

Embryo	Score	Decision
AB-5	9.1	Green checkmark
AB-7	7.2	Blue snowflake
AB-8	8.9	Purple snowflake
AB-9	4.0	Red X

5.1 Képek, time-lapse videók és annotációk

Az iDAScore segítségével a döntés támogatáshoz megtekintheti az embrióról készült képeket és time-lapse videókat. Az embrióról készített utolsó kép megtekintéséhez vigye a kurzort a szem szimbólumra anélkül, hogy rákattintana a szimbólumra.

This is a close-up screenshot of the first row in the embryo table (AB-5, Score 9.1). The eye icon in the decision column is highlighted with a red square, indicating that hovering over it will display the embryo's image and time-lapse video.

A hozzáadott megjegyzések a kép mellett jelennek meg.

Embryo Comment AB-5

AB-2	2.1	<div style="width: 20%;"></div>	
AB-3	2.0	<div style="width: 20%;"></div>	
AB-4	-	<div style="width: 0%;"></div>	
AB-5	9.1	<div style="width: 80%;"></div>	
AB-6	4.5	<div style="width: 45%;"></div>	

Decision 1


>

>

>

>

>

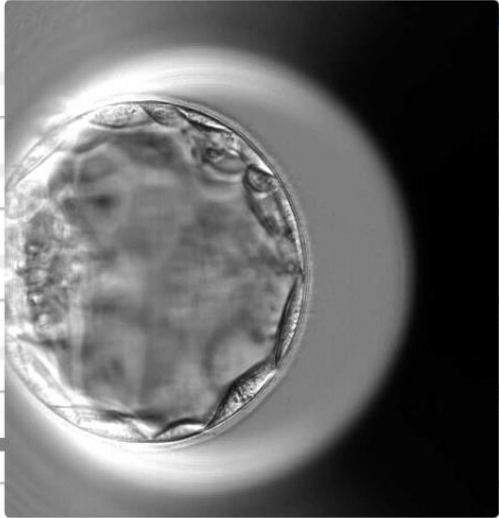

Ha további részleteket szeretne látni az embrióról, kattintson a nyíl szimbólumra.

AB-5

9.1

>

Ez új oldalt nyit meg további információkkal és lehetőségekkel.

iDAScore
13-01-2021 09:52

Patient Overview

First Name
Sophia

Last Name
Brown

Date of Birth
01-02-1990

Patient ID
005

AB-5

Treatment
X9X92020


Score
9.1

PN
2

Comment

Make a Decision

[EmbryoViewer: Annotation](#)

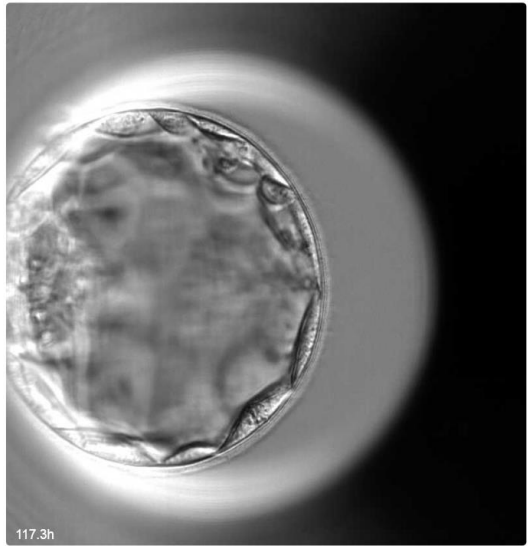

Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5

Az oldal bal oldalán láthatja a paciens adatokat és az előző oldal pontszámát. Azt is láthatja, hogy az embrió melyik kezeléshez tartozik, és hány előmagja (PN) van. Egy figyelmeztető jelzés (!) jelenik meg a **PN** mezőben, ha nem áll rendelkezésre PN becslés, és az előmagok száma nem lett annotálva. Ha szeretné módosítani az előmagok számát, azt közvetlenül a **PN** mezőben teheti meg. A változás automatikusan megjelenik az EmbryoViewer szoftverben. A **Comment** (Megjegyzések) mezőben ezen információ alatt adott esetben megjegyzést fűzhet hozzá. Az előző oldalon található döntés gombok itt is elérhetők.

Ha annotációt szeretne végezni, vagy meglévő annotációkat szeretne megtekinteni az EmbryoViewer szoftverben, kattintson az **EmbryoViewer: Annotation** (Annotáció) gombra, hogy közvetlenül az **Annotate** (Annotálás) oldalra kerüljön az EmbryoViewer szoftverben. További információért olvassa el az EmbryoViewer felhasználói kézikönyvének annotációról szóló oldalait. Kattintson az **IDA** gombra az EmbryoViewer szoftverben az iDAScore-ba való visszatéréshez.

Az oldal jobb oldalán time-lapse videót játszhat le az embrióról. Használja a videó alatti lejátszó gombokat a videó lejátszásához vagy szüneteltetéséhez (középső gomb), vagy egy képpel való visszalépéshez (bal gomb) vagy előrelépéshez (jobb gomb). Egy adott időpontra lépéshez húzza az adott időponthoz a csúszkát, vagy kattintson oda a vízszintes sávon közvetlenül a videó alatt. Ha inkább a billentyűzetet használja, nyomja meg a bal vagy a jobb nyíl gombot egy képpel előre- vagy hátralépéshez. Ez akkor hasznos, ha speciális adatokat szeretne ellenőrizni. Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyilakat a videó nagy sebességgel történő előre- vagy visszajátszásához, illetve a szóköz billentyűvel bármikor elindíthatja vagy leállíthatja a videót.

A lejátszó gombok melletti két csúszka segítségével beállítható a videó fényereje (felső csúszka) és kontrasztja (alsó csúszka).

A fókusz sík megváltoztatásához húzza a csúszkát, vagy kattintson a videó jobb oldalán található függőleges sávra egy adott pozícióra. Alternatív megoldásként használja a billentyűzet fel és le billentyűit.

Az embrió adatainak áttekintése után kattintson a **Patient Overview** (Beteg áttekintése) linkre az áttekintés oldalra való visszatéréshez. A módosítások és a megjegyzések automatikusan mentődnek.

6 Véglegesítés és jelentéskészítés

Ha meghozta a döntést minden érintett embrió esetében, kattintson a **Finalise** (Véglegesítés) gombra. A rendszer felkéri egy dátum kiválasztására. Válasszon ki egy dátumot a megjelenő naptárból, és kattintson a **Confirm** (Megerősítés) gombra.

Choose Date

januar 2021

28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Confirm

Az összes embrióról egy embrió-döntéshozatali jelentés készül. A jelentés első oldalán láthatja, hogy hány embriót választottak ki friss beültetésre, fagyasztásra, fagyasztott embrió-beültetésre (FET) vagy mellőzésre.

Vitrolife

14-01-2021

Embryo Decision Report

First Name: Sophia Last Name: Brown Date of Birth: 01-02-1990 Patient ID: 005


Summary


Decision Date: 14-01-2021


Decision	Number
Transfer	1
Freeze	5
FET	0
Avoid	9


Close Save


A következő oldal(ak) a véglegesített embriók, valamint a tenyésztőedény és azon készülék adatait tartalmazzák, amelyben azokat inkubálták. A véglegesített embriókat tartalmazó tenyésztőedényekhez egy oldal készül. Az ábrán látható, hogy a tenyésztőedény mely vájtaiban voltak beültetésre (zöld), fagyasztásra (kék) és mellőzésre (szürke) kiválasztott embriók.


14-01-2021

 **First Name**
Sophia

 **Last Name**
Brown



 **Date of Birth**
01-02-1990


 **Patient ID**
005


Culture Dish AB


Treatment X9X92020 **Dish ID** D2000.01.01_S10006_I0002_P **Instrument** ES+ 0002 **Hours Past Insemination** 117.4


Embryo	Score	Decision
AB-5	9.1	● Transfer
AB-7	7.2	● Freeze
AB-8	8.9	● Freeze

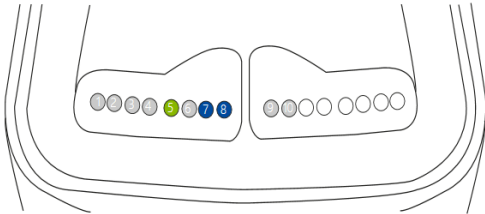




14-01-2021

 **First Name**
Sophia

 **Last Name**
Brown



 **Date of Birth**
01-02-1990

 **Patient ID**
005


Culture Dish AA


Treatment Y2Y22020 **Dish ID** D2000.01.01_S10005_I0001_P **Instrument** ES+ 0001 **Hours Past Insemination** 120.8

Embryo	Score	Decision
AA-3	9.2	● Freeze
AA-4	9.4	● Freeze
AA-5	5.8	● Freeze

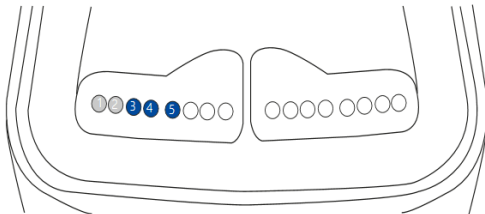




A jelentés utolsó oldalán minden mellőzésre jelölt embrió fel van tüntetve a kezeléssel, a tenyésztőedény azonosítójával és a vájat számával.

14-01-2021

 **First Name**
Sophia


Last Name
Brown

 **Date of Birth**
01-02-1990

 **Patient ID**
005

Avoid

Treatment	Dish ID	Well
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	1
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	2
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	3
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	4
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	6
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	9
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	10
Y2V2_2020	D2000.01.01_S10005_I0001_P	1
Y2V2_2020	D2000.01.01_S10005_I0001_P	2

Close Save 




Kattintson a **Close** (Bezárás) gombra a jelentés mentés nélküli bezárására, vagy kattintson a **Save** (Mentés) gombra a jelentés PDF-formátumba való mentéséhez a kívánt helyre. A jelentés kinyomtatásához kattintson a nyomtató ikonra.

A döntés véglegesítése után a beültetésre vagy mellőzésre kiválasztott embriók nem jelennek meg. Csak a fagyasztott embriók vagy a döntés nélküli embriók láthatók, és a nézet automatikusan az **All** (Összes) lehetőségre vált. Ha a paciensnek a korábbi kezeléseiből vannak fagyasztott embriói, azok is láthatók.

The screenshot shows the iDAScore interface. On the left, the 'Patient' section displays details for Sophia Brown - 005, including her first name, last name, date of birth (01-02-1990), and patient ID (005). The main area is titled 'Embryos' and features a 'Finalise' button and 'Make a Decision' options (checkmark, snowflake, and X). Below this is a table of embryos with columns for Embryo ID, Score, Fresh status, and All status. Each row includes a score, a progress bar, and icons for visibility, freezing, and navigation.

Embryo	Score	Fresh	All	Pronuclei	Decision
AB-7	7.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AB-8	8.9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AA-3	9.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AA-4	9.4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AA-5	5.8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

7 Szimbólumok és címkék

Címke	Leírás	Megjegyzés
	A gyártó nyilatkozata arról, hogy a készülék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendelet összes vonatkozó követelményének.	–
	Orvostechnikai eszköz	–
	Gyártó neve és címe	Lásd a 9. részt.

8 Hulladékkezelés

Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak minimálisra csökkentése érdekében a hulladékot az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU irányelv szerint kell ártalmatlanítani, mely irányelv a 2018/849/EU irányelv szerint módosult. Ez az alábbiakat foglalja magában: nyomtatott áramkörök (ólommentes, tűzi ónozott), kapcsolók, számítógép-akkumulátorok, nyomtatott áramköri táblák és a külső elektromos kábelek. Mindegyik részegység megfelel a 2011/65/EU RoHS 2 irányelvnek, amely előírja, hogy az új elektronikus és elektromos részegységek nem tartalmazhatnak ólmot, higanyt, kadmiumot, hat vegyértékű krómot, polibrómozott bifenilt (PBB) vagy polibrómozott bifenil-étert.

9 Elérhetőségek

Sürgős segítségre van szüksége? Támogatásért hívja a szerviz forródrótját:

+45 7023 0500

(napi 24 órában, a hét minden napján)

Emails támogatás: support.embryoscope@vitrolife.com

(2 munkanapon belül válaszolunk)



Vitrolife A/S
Jens Juuls Vej 20
DK-8260 Viby J
Denmark

Telefonszám: +45 7221 7900

Webhely: www.vitrolife.com



VITROLIFE A/S, DENMARK