


**iDAScore™**

**Kullanım kılavuzu**



## İçindekiler

<b>1 Giriş</b>	<b>3</b>
1.1 Bu kılavuzda kullanılan ifadeler	3
1.2 Önemli kısıtlamalar ve uyarılar	3
1.3 Genel siber güvenlik tavsiyeleri	4
1.4 iDAScore'un amacı	4
1.5 Kullanım amacı	5
1.6 Kullanım endikasyonları	5
1.7 Hedeflenen kullanıcılar	5
1.8 Klinik fayda	5
1.9 Önerilen geçici çözümler	5
1.10 iDAScore kullanımı ile ilgili gereklilikler	6
<b>2 Vitrolife Technology Hub (Vitrolife Teknoloji Merkezi)</b>	<b>7</b>
<b>3 iDAScore – temel işlevler</b>	<b>9</b>
<b>4 Embriyolara verilen puanlar</b>	<b>11</b>
<b>5 Embriyoların seçilmesi</b>	<b>12</b>
5.1 Görüntüler, time-lapse videolar ve açıklamalar	12
<b>6 Sonlandırma ve rapor oluşturma</b>	<b>14</b>
<b>7 Semboller ve etiketler</b>	<b>18</b>
<b>8 Atıkların tahliyesi</b>	<b>19</b>
<b>9 İletişim bilgileri</b>	<b>19</b>

CohortView, CulturePro, EmbryoScope, EmbryoSlide, EmbryoViewer, Guided Annotation, iDAScore ve KIDScore, Vitrolife Group'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

©2021 Vitrolife A/S. Tüm hakları saklıdır.

# 1 Giriş

Bu kullanım kılavuzu, implantasyon olasılığı en yüksek embriyoları otomatik olarak tanımlamak üzere tasarlanan iDAScore'un kullanımı ile ilgili bilgi sağlar.

Kullanım kılavuzunda "EmbryoScope" ile ilgili tüm referanslar EmbryoScope+, EmbryoScope Flex ve EmbryoScope 8 time-lapse inkübatörlerini de kapsar. "EmbryoSlide" ile ilgili tüm referanslar EmbryoSlide+, EmbryoSlide+ ic8 ve EmbryoSlide Flex kültür kaplarını da kapsar.

Bu kullanım kılavuzundaki tüm ekran görüntüleri yazılımın İngilizce sürümünü gösterir. Çeviriler, ilgili yerlerde ekteki metinde verilmiştir.

## 1.1 Bu kılavuzda kullanılan ifadeler

**KULLANIMA İLİŞKİN KISITLAMALAR:** iDAScore kullanılırken belirli kişiler ve amaçlarla sınırlandırılmış işlevler veya eylemler ya da UYULMASI GEREKEN yasal kısıtlamalar.

**UYARILAR:** Talimatlara uygun hareket edilmemesi durumunda, hatalı verilerle ya da geri alınmayacak şekilde veri kaybıyla sonuçlanma riski taşıyan koşul ar ya da eylemler.

**ÖNLEMLER:** iDAScore çalıştırılmadan önce ya da çalıştırıldığı sırada gereken önemli bilgiler.

**NOT:** Aydınlatma amacı doğrultusunda verilen açıklamalar ve ek bilgiler.

## 1.2 Önemli kısıtlamalar ve uyarılar

Tüm iDAScore kullanıcıları bu kullanım kılavuzunu okuyup anladığını kabul etmelidir, kullanıma ilişkin kısıtlamalara uygun hareket etmelidir ve aşağıdaki uyarıları okumalıdır.

Kullanıcılar, cihazın çalıştırılmasının ve ilgili donanımın doğrudan veya dolaylı bir sonucu olarak bir hastada, operatörde veya bakım çalışanında herhangi bir kaza ve/veya yaralanma meydana geldiği takdirde bunu bildirmek için derhal Vitrolife ile irtibata geçmelidir. Cihaz ile ilgili olarak meydana gelen tüm ciddi olaylar, kullanıcının yer aldığı Üye Devlet'in yetkili makamına bildirilmelidir.

### KULLANIMA İLİŞKİN KISITLAMALAR

- iDAScore ile ilgili tüm haklar Vitrolife A/S'ye aittir. iDAScore'u kurmanız ve kullanmanız, son kullanıcı lisans sözleşmesi şartlarına tabidir.
- iDAScore kopyalayamaz, değiştiremez, kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik uygulayamaz, parçalarına ayıramaz veya dönüştüremez veya bir modeli herhangi bir üçüncü şahsa atayamaz, devredemez, satamaz, kiralayamaz veya veremezsiniz.

### UYARI

- iDAScore modeli her embriyoya bir puan atar. En düşük puanlı embriyolar istatistiksel olarak en düşük implantasyon şansına sahiptir ve en yüksek puanlı embriyolar istatistiksel olarak en iyi implantasyon şansına sahiptir. Hangi embriyonun/embriyoların transfer edileceğine, dondurulacağına veya kullanılmayacağına ilişkin karar, ilgili tüm embriyoların kalitesi değerlendirildikten sonra, daima kullanıcı tarafından verilmelidir.

### DİKKAT

- iDAScore, Vitrolife A/S tarafından tasarlanan ve belirtilen dışında başka bir amaçla kullanılamaz, çünkü bu kullanım embriyolog tarafından yanlış kararlar alınmasına neden olabilir.

### NOT

- Bu kılavuzda belirtilen tüm isimler ve tedavi verileri tamamen kurgusaldır.

## 1.3 Genel siber güvenlik tavsiyeleri

Kullanıcıların, cihazın amaçlanan kullanıcı ortamında, tasarlandığı şekilde çalışmasını sağlamak için siber güvenlik riskini azaltmak üzere aşağıdaki önlemleri almaları önerilir:

- Personelin siber güvenlik bilinci konusunda uygun şekilde eğitildiğinden emin olun
- Yetkisiz kullanıcılar tarafından cihaza fiziksel erişimi önleyin
- Güçlü parolalar kullanın (hem büyük hem küçük harfler, sayılar ve en az bir özel karakterden oluşan minimum sekiz karakter).

Kullanıcıların, herhangi bir siber güvenlik açığı durumundan veya güvenlikle ilgili şüpheli olaylardan haberdar olduklarında herhangi bir gecikme olmadan Vitrolife A/S'yi bilgilendirmeleri gerekmektedir.

## 1.4 iDAScore'un amacı

iDAScore, implantasyon şansını en yüksek olan embriyoları otomatik olarak tanımlamak üzere tasarlanmıştır. Klinik karar alma sürecine ve nihai değerlendirmeye ek olarak kullanılır ve karar bir sağlık profesyoneli tarafından verilmelidir.

iDAScore modeli, EmbryoScope time-lapse sisteminde kültürlenmiş embriyonun uygunluğunu öngörmek üzere derin öğrenme nöral ağ tabanlı algoritma ile her embriyoya bir puan atar. Embriyoların puanlanması için kullanılan bilgiler ES server'dan alınır. ES server bağlı EmbryoScope'(lar)dan görüntü verilerini ve EmbryoViewer yazılımından açıklama verilerini alır.

### **DİKKAT**

- iDAScore, seçilen EmbryoSlide kültür kabındaki her bir embriyoya bir puan atar. Bu puan embriyologun kararını sadece destekleyici niteliktedir. Embriyologun kararının yerini almaz.

iDAScore, (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği gereklilikleri doğrultusunda ve söz konusu gerekliliklere uygun bir Sınıf I medikal cihazdır.

## **1.5 Kullanım amacı**

Cihaz, embriyo seçimine yardımcı olmak üzere alınan embriyo time-lapse videolarını kullanarak erken embriyo gelişimini değerlendirir. Cihaz, implantasyon şansı en yüksek olan embriyoları tanımlamak üzere her bir embriyoya bir puan atar. Cihaz, klinik karar alma sürecine ve nihai değerlendirmeye ek olarak kullanılır ve karar bir sağlık profesyoneli tarafından verilmelidir.

## **1.6 Kullanım endikasyonları**

iDAScore, IVF hastalardan alınan embriyoların değerlendirilmesinde kullanılır. iDAScore bir EmbryoScope time-lapse sistemiyle birlikte kullanılmalıdır.

## **1.7 Hedeflenen kullanıcılar**

IVF kliniklerinde çalışan embriyologlar, diğer laboratuvar personeli ve klinik personel.

## **1.8 Klinik fayda**

Medikal cihaz aksesuarı olarak iDAScore, sisteme bağlı inkübatörlerde inkübe edilen embriyoların seçimi konusunda destek sunarak karar verme sürecini iyileştirme alanında dolaylı klinik fayda sağlar.

## **1.9 Önerilen geçici çözümler**

Şu anda iDAScore ile ilgili bilinen herhangi bir anomali veya sınırlandırma söz konusu değildir.

## 1.10 iDAScore kullanımı ile ilgili gereklilikler

iDAScore'u kullanabilmek için ihtiyaç duyulanlar:


- Bir EmbryoScope
- EmbryoViewer yazılımı
- Geçerli bir lisans dosyası yüklü olan ES server.

Dahası, time-lapse video kalitesi önemlidir. Şunları sağlamanız gerekir:

- Embriyo uygun şekilde soyulmuş olmalı ve örneğin kümülüs hücrelerinden arındırılmış olmalıdır
- Kültür kabı başlatıldığında tüm embriyo görülebilir
- Embriyo tüm kültür sürecinde kuyunun ortasında ve odakta olmalıdır
- Kuyuda hava kabarcığı olmamalıdır.

## 2 Vitrolife Technology Hub (Vitrolife Teknoloji Merkezi)

Vitrolife Technology Hub (Vitrolife Teknoloji Merkezi)'da bir modül kullanmak için Vitrolife Technology Hub masaüstü kısayoluna çift tıklayın veya Windows başlatma menüsünden programı başlatın. Şimdi, kliniğinizde kullanılan modüllerin yer aldığı Vitrolife Technology Hub (Vitrolife Teknoloji Merkezi)'in ana sayfa sekmesini göreceksiniz.

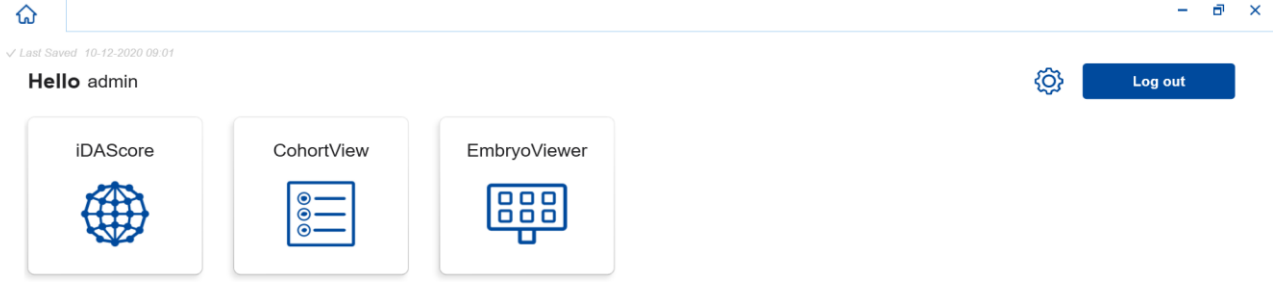

Açmak için bir modüle tıklayın. Birden fazla modül açarsanız her bir modül yeni bir sekmede açılacaktır. Açık olan herhangi bir sekmeyi, sekmedeki X'e tıklayarak kapatabilirsiniz.

**Log Out** (Oturumu Kapat) düğmesinin yanındaki ayarlar simgesi, sistem ve modül ayarlarına erişim sağlar.



✓ Last Saved 10-12-2020 09:05

< Dashboard

## System Settings

### Language

English (United Kingdom) ↓

### Automatic Logout After Inactivity

10

Minutes



### Platform Version

1.2.0

## Module Settings

iDAScore ↓

CohortView ↓

**System Settings** (Sistem Ayarları) altında **Language** (Dil) aşağı açılır listesinde kullanılacak ekran dilleri arasından seçim yapabilir, **Automatic Logout After Inactivity** (Etkinlik Olmadığında Otomatik Çıkış) altında kullanıcıların otomatik olarak çıkış yapması için herhangi bir işlem yapmadan geçecek süreyi belirleyebilirsiniz ve **Platform Version** (Platform Versiyonu) altında mevcut platform versiyonunu görebilirsiniz.

**Module Settings** (Modül Ayarları) altında belirli bir modülün mevcut versiyonunu ve UDI (benzersiz cihaz tanımlaması) kodunu görebilirsiniz. Bu bilgiyi açmak veya kapatmak için modülün yanındaki ok işaretine tıklayın.

Modüle genel bakışa geri dönmek için **Dashboard** (Panel) bağlantısına tıklayın.



## 3 iDAScore – temel işlevler

iDAScore'u ilk kez açtığınızda açılış sayfasında bilgi yoktur.

✓ Last Saved 10-12-2020 09:08

**Patient**

Search

First Name

Last Name

Date of Birth

Patient ID

EmbryoViewer: Patient Details

EmbryoViewer: Compare & Select

...

**Embryos**

Embryo ↓ Score ↓ Fresh  All

Finalise

Make a Decision

Pronuclei ↓ Decision ↓

Belirli bir hasta veya tedaviyi aramak için ekranın sol tarafındaki arama alanına bir hasta adı, hasta kimliği veya tedavi kimliği girin.

**First Name** (Adı), **Last Name** (Soyadı), **Date of Birth** (Doğum Tarihi) ve **Patient ID** (Hasta Kimliği) alanları otomatik olarak hasta bilgileriyle doldurulur ve hastanın embriyolarının puanları hesaplanıp ekranın sağ tarafında görüntülenir. Sadece taze embriyoların puanlarını görmek için **Fresh** (Taze) seçeneğini; hem taze hem dondurulmuş embriyoların puanlarını görmek için **All** (Tümü) seçeneğini belirleyin. Taze embriyolar, son 10 günde döllenmiş embriyolardır.

The screenshot displays the iDAScore application interface. On the left, the 'Patient' section shows details for 'Sophia Brown - 005', including First Name (Sophia), Last Name (Brown), Date of Birth (01-02-1990), and Patient ID (005). Below this are two buttons: 'EmbryoViewer: Patient Details' and 'EmbryoViewer: Compare & Select'. The main area is titled 'Embryos' and features a table with columns for Embryo ID, Score, Fresh status, All status, Pronuclei, and Decision. The table lists 10 embryos (AB-1 to AB-10) with their respective scores and visual progress bars. A 'Finalise' button and 'Make a Decision' options (checkmark, snowflake, and X) are located at the top right. A search bar at the top left contains 'Sophia Brown - 005'.

Embryo	Score	Fresh	All	Pronuclei	Decision
AB-1	3.7				
AB-2	2.1				
AB-3	2.0				
AB-4	-			1 PN!	
AB-5	9.1				
AB-6	4.5				
AB-7	7.2				
AB-8	8.9				
AB-9	4.0				
AB-10	1.8				

Hesaplamaları embriyo kimliği, puan ve pronükleus sayısına göre sıralayabilirsiniz. Embriyolar için bir karar verilmişse (bkz. bölüm 5) karara göre de sıralayabilirsiniz. Verileri büyükten küçüğe sıralamak için ilgili başlığa bir kez, küçükten büyüğe sıralamak için ise iki kez tıklayın. Varsayılan olarak hesaplamalar embriyo kimliğine göre küçükten büyüğe doğru görüntülenir. Sıralamayı değiştirecek olursanız hasta verilerini bir daha açtığınızda veriler varsayılan sıralamaya geri dönmüş şekilde görüntülenir.

Ayrıntılı hasta ve tedavi bilgilerini görmek veya hastanın embriyolarına bir puanlama modeli uygulamak istiyorsanız EmbryoViewer yazılımında **Patient Details** (Hasta Ayrıntıları) veya **Compare & Select** (Karşılaştır ve Seç) sayfasına doğrudan girmek için ekranın sol alt tarafındaki iki düğmeyi kullanabilirsiniz. Bu sayfalarla ilgili daha fazla bilgi edinmek için EmbryoViewer kullanım kılavuzuna bakın.

[EmbryoViewer: Patient Details](#)

[EmbryoViewer: Compare & Select](#)

Vitrolife Technology Hub'da başka bir modüle doğrudan gitmek için ekranın sol alt tarafındaki üç noktalı düğmeye tıklayın. Düğmeye tıkladığınızda görüntülenen listeden bir seçenek belirleyin.



## 4 Embriyolara verilen puanlar

Tüm embriyolara 1 ila 9,9 arasında sayısal bir puan verilir ve puan çubuğu embriyo için bir karar verilene kadar koyu gri görünür (bkz. bölüm 5). Puan hesaplanamazsa puan çubuğu açık gri görünür. Ayrıntılı bilgileri görüntülemek için imleci **Score** (Puan) sütununundaki kısa çizginin üzerine getirin.



### DİKKAT

- Puan hesaplanabilmesi için kültür kabı döllenmeden en geç 24 saat sonra inkübatöre yerleştirilmelidir.
- Kültür kabı 112 saatten az çalıştırılmışsa bilgi görüntülenmez.

En yüksek puanlı embriyolar istatistiksel olarak en yüksek implantasyon şansına sahiptir. Hangi embriyoların transfer edileceği, dondurulacağı ya da kullanılmayacağıyla ilgili nihai karar daima embriyolog tarafından, her bir embriyo dikkatle değerlendirildikten sonra verilmelidir. Puanlar bu kararı destekleyebilir ama hiçbir zaman yerini tutmaz.

Embriyoda iki pronükleus (PN) yoksa embriyo için puan görüntülenmez ve PN değeri bir uyarı simgesi ile (!) **Pronuclei** (Pronükleus) altında görüntülenir. Gerekirse PN değerini elle değiştirebilirsiniz (bkz. bölüm 5.1).



Tahmini PN değeri yoksa ve PN değeri açıklanmamışsa ya da **NA** (YOK) olarak açıklanmamışsa embriyo için bir puan görüntülenir ve **Pronuclei** (Pronükleus) altında bir uyarı simgesi görüntülenir. Ayrıntılı bilgileri görüntülemek için imleci uyarı simgesinin üzerine getirin.



## 5 Embriyoların seçilmesi

Bir hasta için embriyo puanları görüntülediğinde hangi embriyoların transfer edileceğini (yeşil simge), dondurulacağını (mavi simge) veya kullanılmayacağını (kırmızı simge) göstermek üzere **Make a Decision** (Karar Ver) altındaki karar düğmelerini kullanabilirsiniz. Yeşil simgeli karar düğmesi transfer edilecek yeni ve dondurulmuş embriyoları seçmek için kullanılabilir. Düğmelerden birine tıkladığınızda ilgili simge imleci takip edecek ve tüm embriyolar için **Decision** (Karar) altında bir onay kutusu görünecektir. Kararı uygulamak istediğiniz tüm embriyolar için onay kutusuna tıklayın. İmleci normal kullanımına geri döndürmek için aynı karar düğmesine tekrar tıklayın veya bir ya da daha fazla embriyo için farklı bir karar uygulamak için farklı karar düğmelerinden birine tıklayın.

Bir kararı geri almak istiyorsanız ilgili karar düğmesine tıklayın, ardından kararı değiştirilecek embriyo için onay kutusuna tıklayın. Bu, onay kutusunu temizleyecektir.

Bir embriyoya bir karar uyguladığınızda embriyonun puan çubuğu uygun bir renge dönüşür. Taze transfer için seçilen embriyolar için puan çubuğu yeşile dönüşür. Dondurulmak üzere seçilen embriyolar için maviye dönüşür ve transfer edilecek dondurulmuş embriyolar için mora dönüşür. Kullanılmamak üzere işaretlenen embriyolar için tüm sıra kararmış görünür.

Embryos

Finalise

Make a Decision

Embryo ↓ Score ↓ Fresh  All  Pronuclei ↓ Decision ↓

AB-5	9.1	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>			
AB-7	7.2	<div style="width: 70%; height: 10px; background-color: #4169E1;"></div>			
AB-8	8.9	<div style="width: 80%; height: 10px; background-color: #800080;"></div>			
AB-9	4.0	<div style="width: 20%; height: 10px; background-color: #A9A9A9;"></div>			

### 5.1 Görüntüler, time-lapse videolar ve açıklamalar


iDAScore, kararlarınızı desteklemek üzere embriyo görüntülerini ve time-lapse videolarını görüntülemenize olanak tanır. Bir embriyonun çekilen son görüntüsünü görmek için imleci göz simgesinin üzerine getirin ancak simgeye tıklamayın.

AB-5	9.1	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #A9A9A9;"></div>		
------	-----	---	--	--

Eklene tüm yorumlar görüntünün yanında görüntülenir.

**Embryo Comment AB-5**

AB-2	2.1	<div style="width: 20%;"></div>
AB-3	2.0	<div style="width: 20%;"></div>
AB-4	-	<div style="width: 0%;"></div>
AB-5	9.1	<div style="width: 100%;"></div>
AB-6	4.5	<div style="width: 45%;"></div>



Decision 1

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

Embriyo ile ilgili ayrıntıları görmek istiyorsanız ok simgesine tıklayın.

AB-5 | 9.1

>

>

Bu şekilde ek bilgiler ve seçeneklerle yeni bir sayfa açılır.

iDAScore
13-01-2021 09:52

**Patient Overview**

**First Name**  
Sophia

**Last Name**  
Brown

**Date of Birth**  
01-02-1990

**Patient ID**  
005

---

**AB-5**

**Treatment**  
X9X92020


**Score**  
9.1

**PN**  
2

**Comment**

**Make a Decision**

**EmbryoViewer: Annotation**



117.3h

Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5

⏪
⏩
⏮
⏭

Sayfanın sol tarafında hasta ayrıntılarını ve önceki sayfadaki puanı görebilirsiniz. Bunun yanı sıra embriyoya uygulanan tedaviyi ve pronükleus sayısını (PN) görebilirsiniz. PN tahmini yoksa ve pronükleus sayısı belirtilmemişse **PN** alanının yanında bir uyarı simgesi (!) görüntülenir. Pronükleus sayısını değiştirmek istiyorsanız bunu doğrudan **PN** alanında yapabilirsiniz. Değişiklik otomatik olarak EmbryoViewer yazılımında görüntülenecektir. Bu bilginin altındaki **Comment** (Yorum) alanına gerekliyse bir yorum girebilirsiniz. Önceki sayfada yer alan karar düğmeleri de burada kullanılabilir.

EmbryoViewer yazılımında açıklamaları uygulamak veya mevcut açıklamaları görüntülemek istiyorsanız **EmbryoViewer: Annotation** (Açıklamalar) düğmesine tıklayarak doğrudan EmbryoViewer yazılımında **Annotate** (Açıklama) sayfasına gidebilirsiniz. Bu açıklamalarla ilgili daha fazla bilgi edinmek için EmbryoViewer kullanım kılavuzuna bakın. iDAScore'a geri dönmek için EmbryoViewer yazılımında **IDA** düğmesine tıklayın.

Sayfanın sağ tarafında embriyonun time-lapse videosunu oynatabilirsiniz. Videoyu oynatmak veya duraklatmak, (orta düğme) veya görüntüyü geri (sol düğme) veya ileri (sağ düğme) almak için videonun altındaki oynatma düğmelerini kullanın. Bunun yanı sıra videonun hemen altındaki yatay çubuk üzerindeki kaydırıcıyı sürükleyebilir veya çubuğun herhangi bir noktasına tıklayabilirsiniz. Klavyeyi kullanmak isterseniz sırasıyla bir görüntüyü geri ya da ileri almak için sol veya sağ ok tuşlarına basın. Bu, belli ayrıntıları kontrol etmek için kullanılabilir. Videoyu yüksek hızda geri ileri oynatmak için ok tuşlarına basılı tutun, videoyu başlatmak veya durdurmak için space tuşuna basın.


Oynatma düğmelerinin yanındaki iki kaydırıcı videonun parlaklığını (üstteki kaydırıcı) ve kontrastını (alttaki kaydırıcı) ayarlamak için kullanılabilir.

Odak düzlemini değiştirmek için videonun sağ tarafındaki dikey çubuğun üzerindeki kaydırıcıyı sürükleyin veya çubuk üzerinde herhangi bir noktaya tıklayın. Alternatif olarak klavyedeki yukarı ve aşağı tuşlarını kullanın.


Embriyo ayrıntılarını inceledikten sonra genel görünüm sayfasına geri dönmek için **Patient Overview** (Hasta Genel Görünümü) üzerine tıklayın. Değişiklikler veya yorumlar otomatik olarak kaydedilir.

## 6 Sonlandırma ve rapor oluşturma

İlgili tüm embriyolar için bir karar verdiğinizde **Finalise** (Sonlandır) düğmesine tıklayın. Şimdi bir tarih seçmeniz istenecek. Görüntülenen takvimde bir tarih seçin ve **Confirm** (Onayla) üzerine tıklayın.

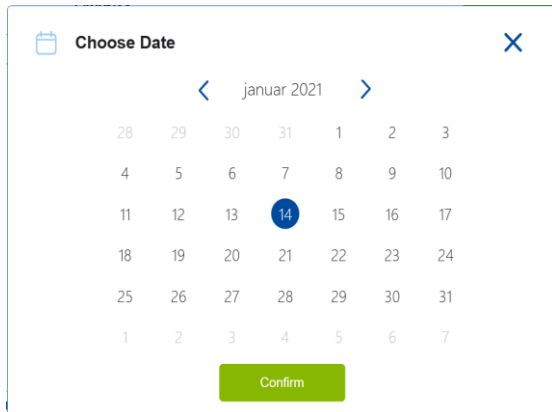

Bir karara vardığınız tüm embriyolar için bir embriyo karar raporu görüntülenir. Bu raporun birinci sayfasında taze transfer, dondurma, dondurulmuş embriyo transferi (FET) için veya kullanılmamak üzere seçilmiş embriyo sayısını görebilirsiniz.

14-01-2021


### Embryo Decision Report

**First Name** Sophia **Last Name** Brown **Date of Birth** 01-02-1990 **Patient ID** 005

#### Summary

**Decision Date** 14-01-2021

Decision	Number
<input checked="" type="radio"/> Transfer	1
<input checked="" type="radio"/> Freeze	5
<input type="radio"/> FET	0
<input type="radio"/> Avoid	9

[Close](#) [Save](#) 

Sonraki sayfa(lar)da sonlandırılmış embriyolar ve kültür kapları ile inkübe edildikleri cihazların ayrıntıları yer alır. Sonlandırılan embriyoları içeren her kültür kabı için bir sayfa oluşturulacaktır. Şekilde; transfer edilmek (yeşil), dondurulmak (mavi), ve kullanılmamak (gri) üzere seçilen embriyoların yer aldığı kültür kaplarının hangi kuyularda olduğu gösterilir.



**First Name**  
Sophia

**Last Name**  
Brown



**Date of Birth**  
01-02-1990





**Patient ID**  
005

#### Culture Dish AB

**Treatment** X9X92020 **Dish ID** D2000.01.01\_S10006\_I0002\_P **Instrument** ES+ 0002 **Hours Past Insemination** 117.4

Embryo	Score	Decision
AB-5	9.1	● Transfer
AB-7	7.2	● Freeze
AB-8	8.9	● Freeze



**First Name**  
Sophia

**Last Name**  
Brown



**Date of Birth**  
01-02-1990





**Patient ID**  
005

#### Culture Dish AA


**Treatment** Y2Y22020 **Dish ID** D2000.01.01\_S10005\_I0001\_P **Instrument** ES+ 0001 **Hours Past Insemination** 120.8


Embryo	Score	Decision
AA-3	9.2	● Freeze
AA-4	9.4	● Freeze
AA-5	5.8	● Freeze







Raporun son sayfasında kullanılmamak üzere işaretlenen tüm embriyolar tedavi, kültür kabı kimliği ve kuyu numarasıyla sıralanmıştır.

14-01-2021

 **First Name**  
Sophia

**Last Name**  
Brown


 **Date of Birth**  
01-02-1990

 **Patient ID**  
005

---

**Avoid**

Treatment	Dish ID	Well
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	1
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	2
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	3
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	4
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	6
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	9
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	10
Y2V2_2020	D2000.01.01_S10005_I0001_P	1
Y2V2_2020	D2000.01.01_S10005_I0001_P	2




Close Save 

Raporu kaydetmeden kapatmak için **Close** (Kapat) üzerine tıklayın veya raporu tercih ettiğiniz konumda PDF biçiminde kaydetmek için **Save** (Kaydet) üzerine tıklayın. Raporu yazdırmak isterseniz yazıcı simgesine tıklayın.

Kararlarınızı sonlandırdıktan sonra transfer için veya kullanılmamak üzere seçilen embriyolar artık görüntülenmez. Sadece dondurulan embriyolar ve herhangi bir karar verilmemiş embriyolar görüntülenir ve görünüm otomatik olarak **All** (Tümü) olacak şekilde değiştirilir. Hastanın önceki tedavilerinden dondurulmuş embriyosu varsa, bunlar da görüntülenir.

The screenshot shows the iDAScore web application interface. On the left, there is a 'Patient' section with a search bar containing 'Sophia Brown - 005'. Below the search bar, patient details are listed: First Name (Sophia), Last Name (Brown), Date of Birth (01-02-1990), and Patient ID (005). The main area is titled 'Embryos' and displays a table of embryos with their scores and decision options. The table has columns for Embryo, Score, Fresh, All, Pronuclei, and Decision. The embryos listed are AB-7 (Score 7.2), AB-8 (Score 8.9), AA-3 (Score 9.2), AA-4 (Score 9.4), and AA-5 (Score 5.8). Each embryo row includes a progress bar, an eye icon, a snowflake icon, and a right arrow icon. At the top right of the embryo list, there is a 'Finalise' button and a 'Make a Decision' section with three icons: a green checkmark, a snowflake, and a red X.

## 7 Semboller ve etiketler

Etiket	Açıklama	Not
	Cihazın (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerini karşıladığını gösteren üretici beyanı	-
	Medikal cihaz	-
	Üreticinin adı ve adresi	Bkz. bölüm 9.

## 8 Atıkların tahliyesi

Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarını minimuma indirmek için, atıkların 2018/849 sayılı AB Direktifi ile değiştirilmiş elektrikli ve elektronik ekipman atıklarına yönelik (WEEE) 2012/19/AB sayılı Direktife göre atılması gerekmektedir. Bu, şunları içerir: PCB'ler (kurşun içermeyen HASL), anahtarlar, bilgisayar bataryaları, baskılı devre kartları ve harici elektrik kabloları. Tüm bileşenler, yeni elektrikli ve elektronik bileşenlerin kurşun, cıva, kadmiyum, altı değerlikli krom, polibromine bifeniller (PBB) veya polibromine difenil eter içermediğini belirten 2011/65/AB sayılı RoHS 2 Direktifi ile uyumludur.

## 9 İletişim bilgileri

Acil yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için servis yardım hattımızı arayın:

**+45 7023 0500**

(7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz)

**E-posta desteği: [support.embryoscope@vitrolife.com](mailto:support.embryoscope@vitrolife.com)**

(2 çalışma günü içerisinde yanıt)



Vitrolife A/S

Jens Juuls Vej 20

DK-8260 Viby J

Danimarka

Telefon: +45 7221 7900

Web sitesi: [www.vitrolife.com](http://www.vitrolife.com)

**Vitrolife**

VITROLIFE A/S, DANİMARKA